

-20°C DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CİHAZ DİKEY TİPTE OLMALIDIR.
2. DOLABIN İÇ HACMİ EN AZ 276 LİTRE OLMALIDIR.
3. DOLABIN EN AZ 5 ADET ÇEKMECELİ RAFI BULUNMALIDIR.
4. DOLAP DİREKT SOĞUTMA SİSTEMİ İLE ÇALIŞMALI VE + 0.5°C'DE - 20°C'YE KADAR SOĞUTMA YAPABİLMELİDİR.
5. DOLAPTA CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU GAZ KULLANILMALIDIR.
6. DOLAPTA SESLİ VE IŞIKLI YÜKSEK ISI ALARMI BULUNMAKTADIR.
7. DOLAPTA İLK ÇALIŞMA ERTELEME OLMALIDIR. FAST FREEZE(HIZLI DONDURMA) BUTONU İLE HIZLI SOĞUTMA İHTİYACI HALİNDE KOMPRESÖRÜ DEVREDE TUTABİLMELİDİR.
8. DOLABIN KONTROL PANELİ KOLAY KULLANIMLI VE TUŞLU OLMALIDIR.
9. DOLABIN HERMETİK TİP KOMPRESÖRÜ OLMALI, SESSİZ ÇALIŞMALI VE GÜÇ TÜKETİMİ 440W'I GEÇMEMELİDİR.
10. SATICI FİRMA FABRİKASYON HATALARA KARŞI İKİ YIL ÜCRETSİZ, TAKİP EDEN ON YIL KARŞILIĞINDA YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİSİ VERMELİDİR.


TEKNİSYEN

YUNUS EMRE ŞALIŞ



TEKNİSYEN

RECEP ÖNDER BAYSAL

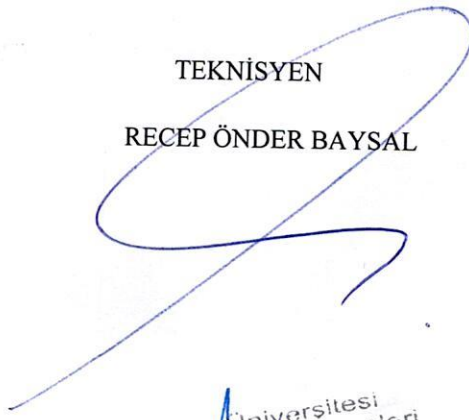

TEKNİSYEN

GÖRKEM ALTAN



Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri
Doç.Dr. Aliyca KIRMIZI
Dip. Tes. No: 18589
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı