


191716


Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Halkası
14,1cm x14,1cm (Ürün Katalog Referans: 3307G)

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Retraktör üzerinde aynı marka silikon stay takılabilecek çentikler olmalıdır. Bu çentikler sayesinde cerrahi erişim için takılacak kancalar ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
3. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
4. Retraktör parçaları birbirine plastik vidalar aracılığıyla monte edilebilmelidir ve pozisyonu sıkma vidaları aracılığı ile sabitlenmeli, verilen pozisyon bozulmamalıdır. Ürün metal parça içermemelidir.
5. Retraktör parçaları 4 adet sıkma vidası ile birbirine bağlanıp 14,1cm x 14,1cm ölçülerinde ring formatını oluşturmaktadır.
6. Retraktör dört adet özel sert plastik parçadan oluşmaktadır.


Prof.Dr. Bulent ERKEK

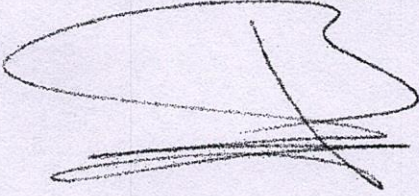

Doç.Dr. Şiyar ERSÖZ

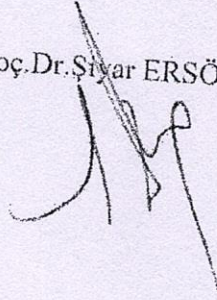

Uzm.Dr.S.Utku ÇELİK



191716

**Rekonstrüktif Cerrahi Esnek Retraksiyon Hook
7mm 2 Parmak (Ürün Katalog Referans: 3327-4G)**

1. Cerrahi girişim ve yerine göre farklı şekil ve ölçülerde tasarlanmış olmalıdır. Dış kutusu üzerinde, farklı şekil ve ölçülerde ait görseller ve kod numaraları basılı olmalıdır.
2. Uç hook kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş olup opsiyonel olarak tek, çift, üçlü yapıda ; keskin, küt ve yarı-küt özelliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
3. Hook ve silikon tubing olmak üzere birleşik 2 kısımdan oluşmalıdır ve birleşim yeri rahat tutulacak olmalıdır.
4. Hook ve silikon tubing birleşim yerinden kopmamalıdır.
5. Slikon tubing kısmı esnemeli, aynı marka retraktör çentiğine takılmalıdır. Cerrahi erişim için ihtiyaca bağlı olarak lateral ve horizontal açıları ayarlanabilir olmalıdır. Ürün, girişim alanında yüzeysel dokuları geri çekerek geniş bir anatomik görüş alanı ve erişim kolaylığı sağlamalıdır.
6. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır. Orijinal ambalajı bozulmamış ürün, UTS tekil takip sistemi üzerinden kurumun talep ve bildirimini doğrultusunda farklı şekil ve ölçülerde ürün değiştirilebilmelidir.
 1. Teklif edilecek ürün uç kısmı 7mm ölçülerinde 2 parmak metal kanca formunda olmalıdır.
 7. Kutu içinde yeşil renk kodlu 4 adet stay bulunmalıdır.
 8. Ürünün ameliyathanede değerlendirilmesi için numune bırakılmalıdır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Y. İ. ÇELİK
Dış. Teles. No: 197568

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi A.B.D.
Pazarcık Camii Cerrahi Bld.
Dr. Öğr. Üyesi Can Yılmaz ÖZTÜRK
Dış. Teles. No: 197014

Prof. Dr. Can ÖZGÜRSOY
Ank. Üniv. Tıp Fak. Hastaneleri
KBB Hastahane Anabilim Dalı
Prof. Dr. Can ÖZGÜRSOY
Dış. Teles. No: 197075